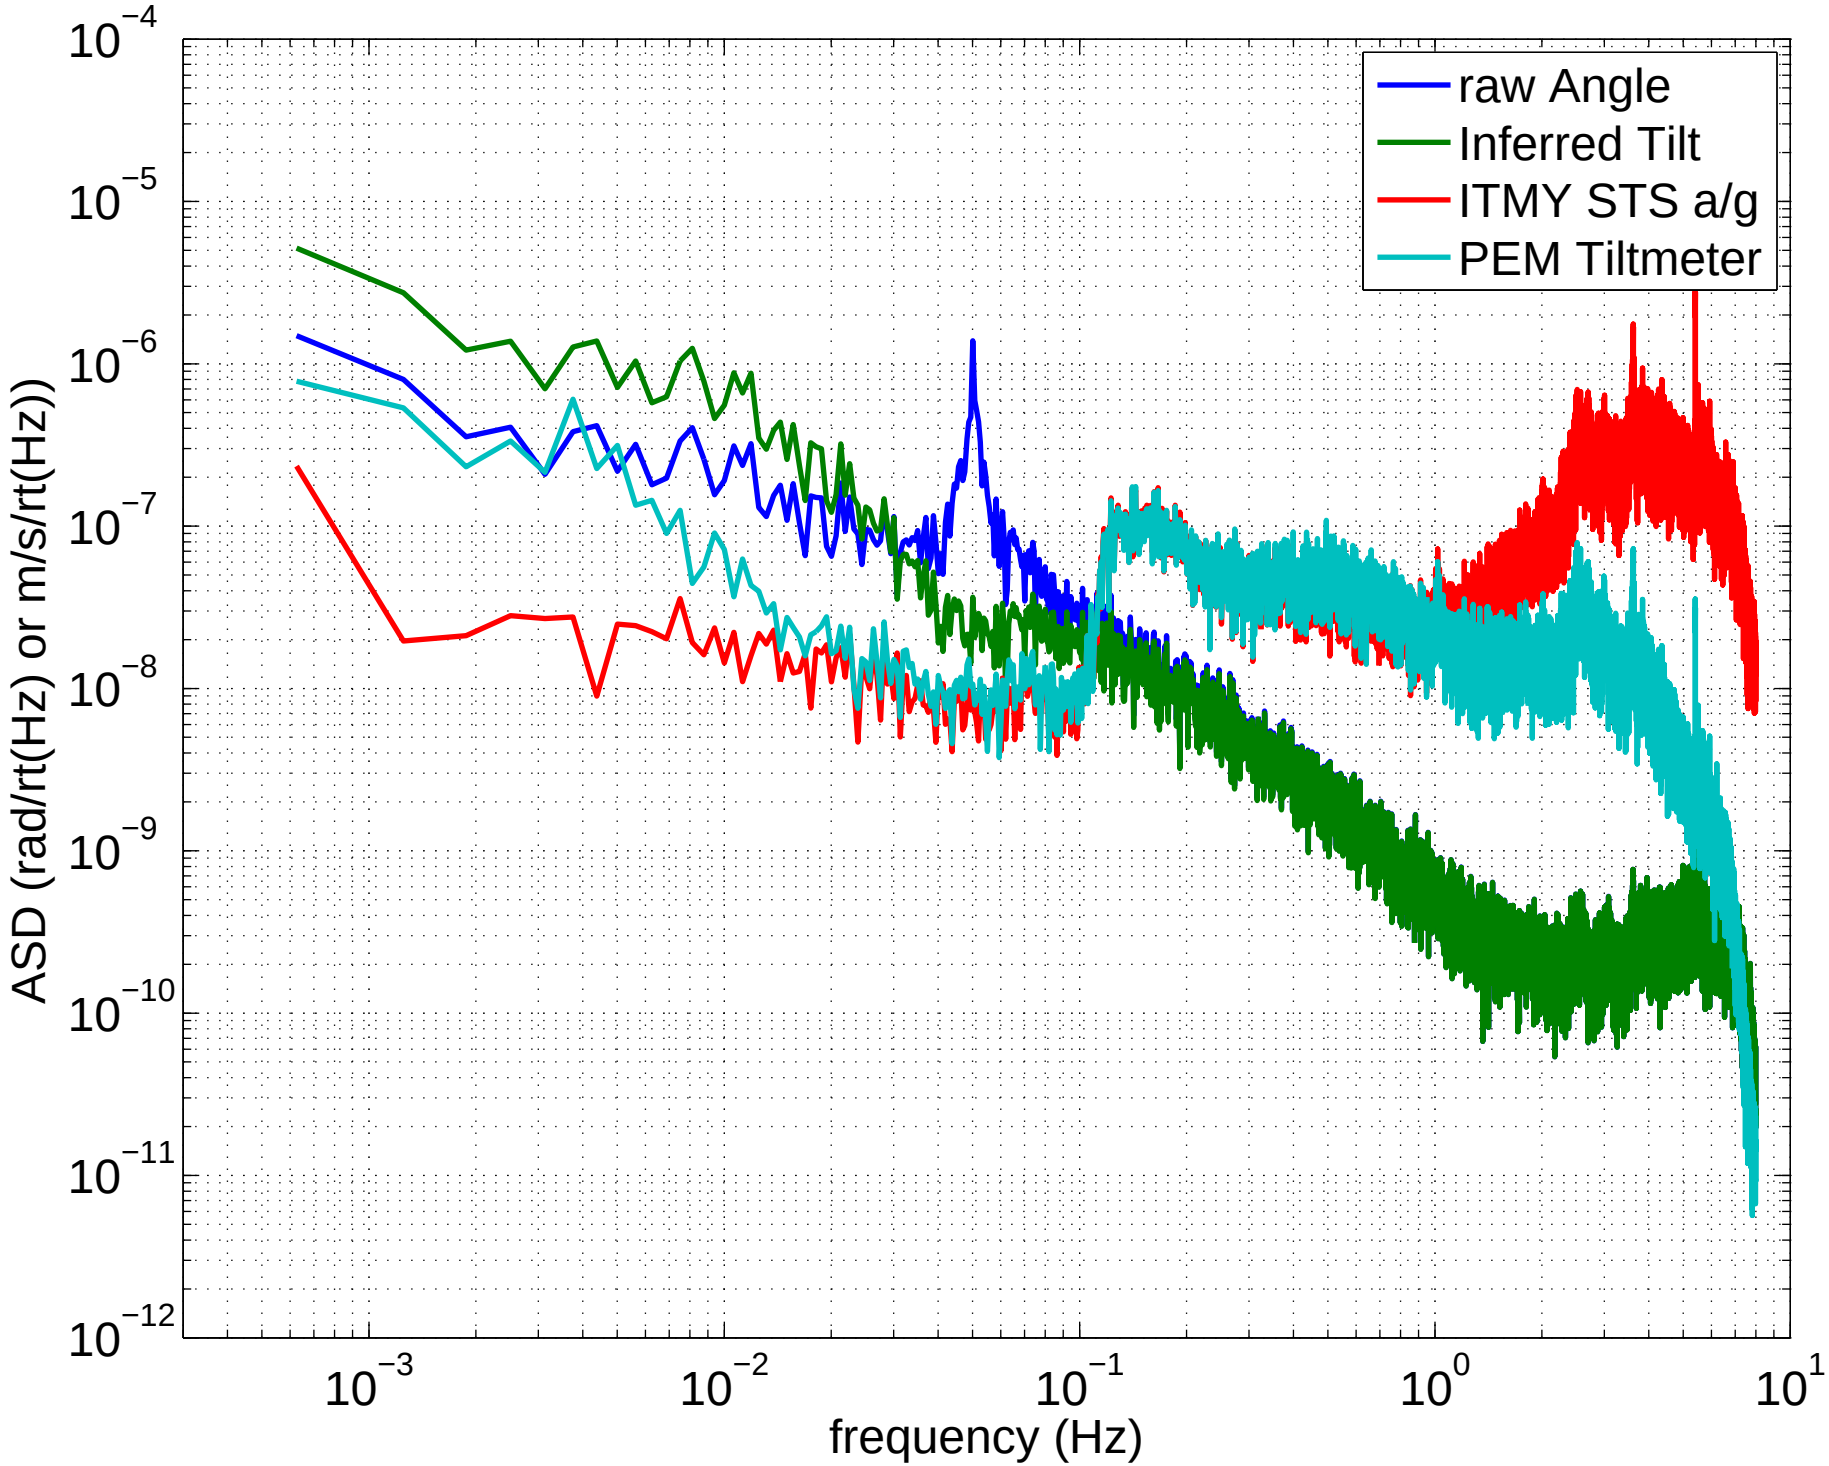
raw Angle
Inferred Tilt
ITMY STS a/g
PEM Tiltmeter
ASD (rad/rt(Hz) or m/s/rt(Hz))
frequency (Hz)
10^{-4}
10^{-5}
10^{-6}
10^{-7}
10^{-8}
10^{-9}
10^{-10}
10^{-11}
10^{-12}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}

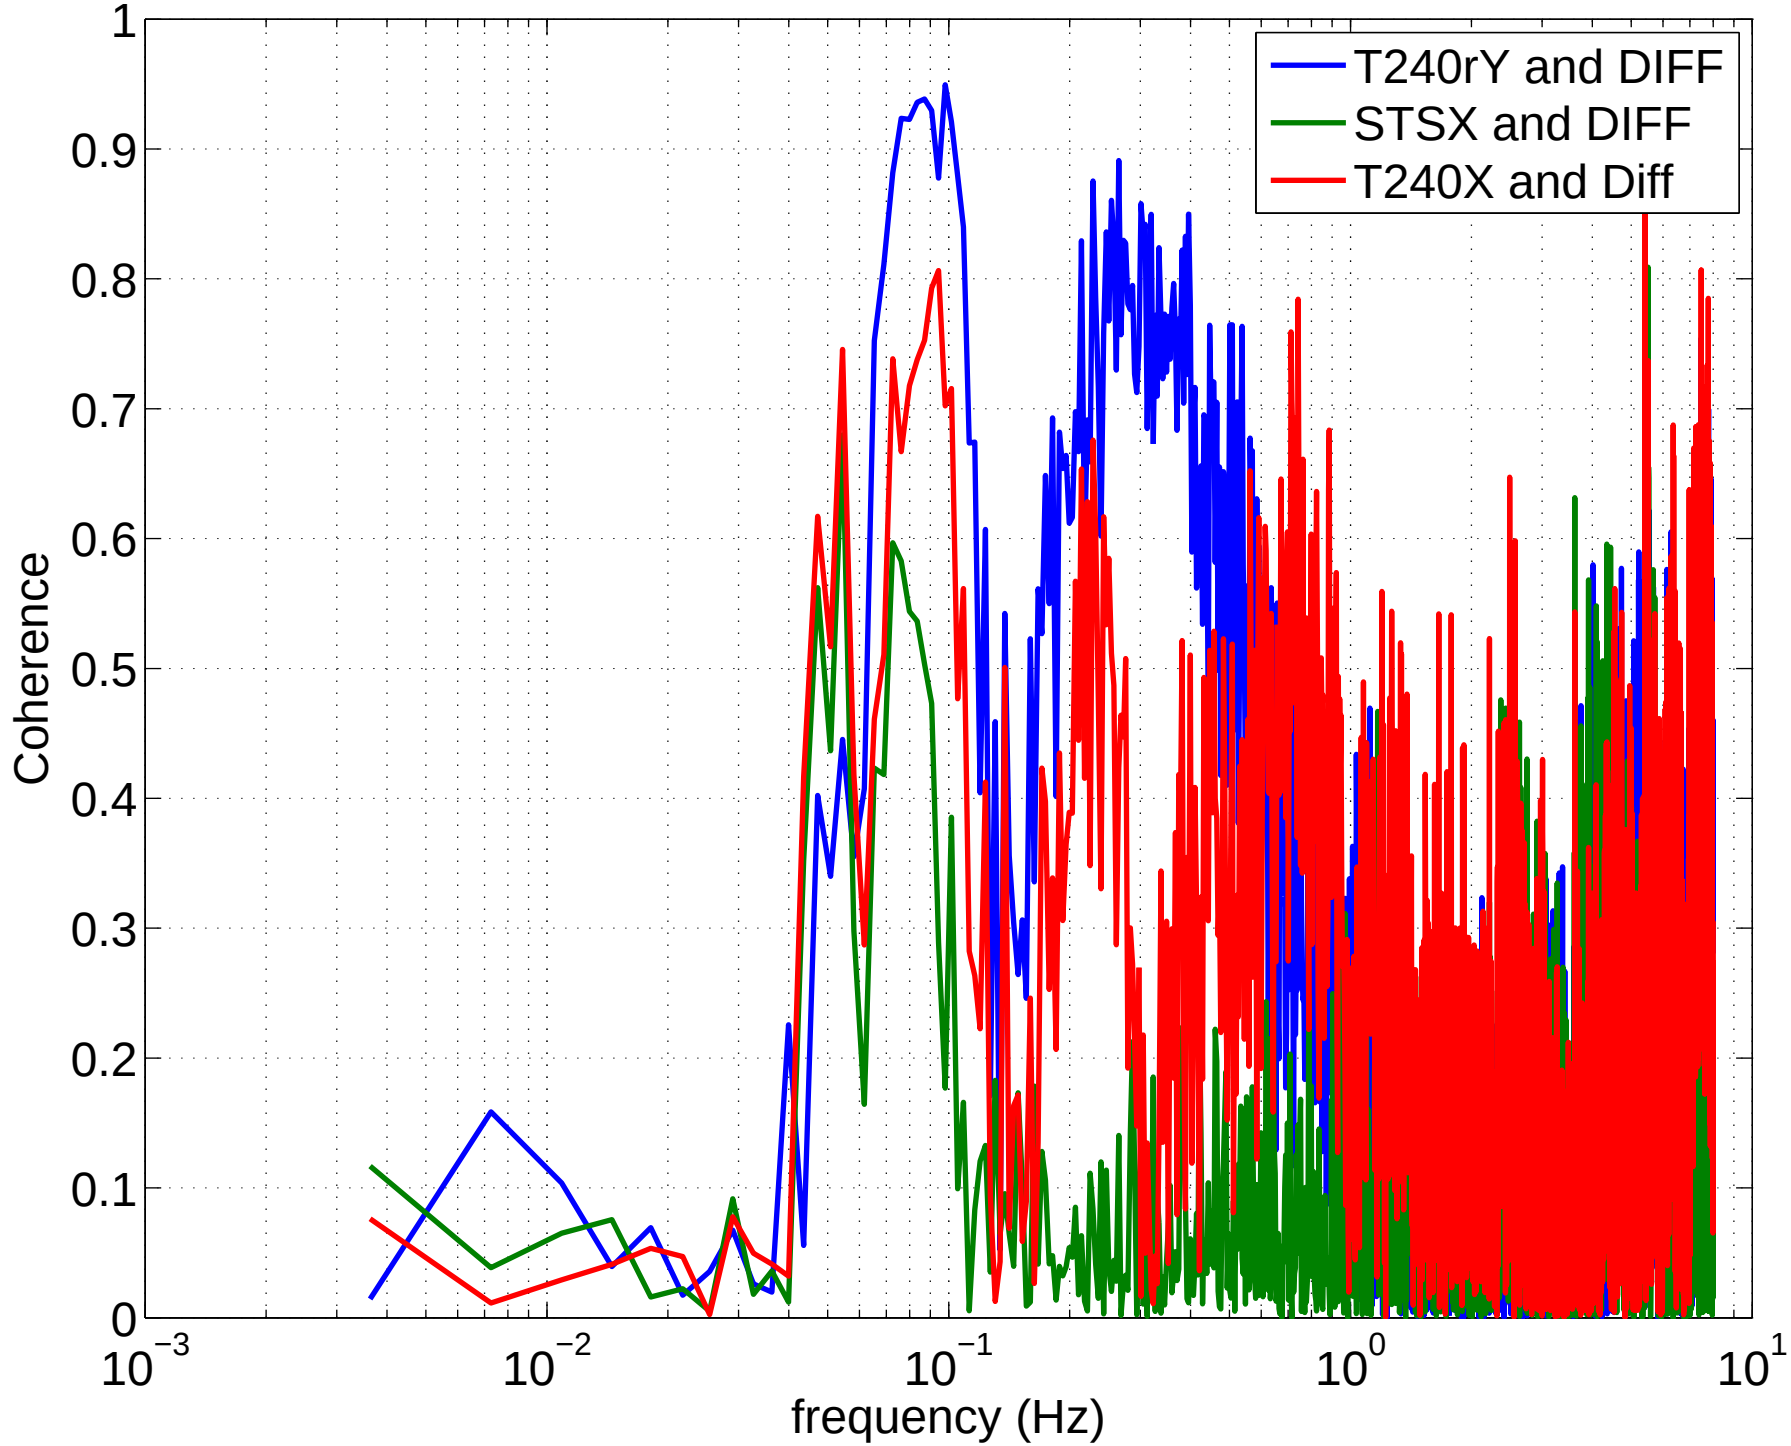
T240rY and DIFF
STSX and DIFF
T240X and Diff
Coherence
frequency (Hz)
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
10^{0}
10^{1}